

谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）试剂盒说明书

（货号：ADS-W-G003-48 微板法 48 样）

一、产品简介：

谷胱甘肽过氧化物酶（GPx, EC 1.11.1.9）代表一种具有过氧化物酶活性的酶家族，在保护生物免受氧化损伤中起重要作用。以往以过氧化氢为底物进行检测，则会受到分解过氧化氢的过氧化氢酶(Catalase)的干扰，本试剂盒提供的有机过氧化物试剂(Cum-OOH)不会被过氧化氢酶分解，因而可以特异地检测出谷胱甘肽过氧化物酶的活力。因此本试剂盒可以定量检测总谷胱甘肽过氧化物酶。

GSH 和 DTNB 反应产生黄色物质，后者在 412nm 下有最大吸收峰，而 GSH-Px 催化有机过氧化物试剂(Cum-OOH)氧化 GSH，使 GSH 量减少，GSH 量减少越多，反应混合液黄色越浅，则 GSH-Px 活性越大；反之，黄色越深，GSH-Px 活性越低。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	4mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	2mL×1 瓶	4℃保存	
试剂三	40mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	5 mL×1 瓶	4℃保存	
试剂五	1mL×1 瓶	4℃保存	若冷藏后呈固体, 可 25℃水浴 5min 融化即可。
标准品	粉体 1 支	4℃保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

三、所需的仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、低温离心机、移液器、研钵、冰和蒸馏水。

四、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性测定：

建议正式实验前选 2 个样本做预测定，了解样品情况和熟悉实验流程，避免样本和试剂浪费！

1、样本制备：

- ① 组织样本：称取约 0.1g 组织（水分充足样本可取 0.5g），加入 1mL 提取液，在 4℃ 或冰浴匀浆(或使用各类常见电动匀浆器)。4℃ 约 12,000rpm 离心 10min，取上清待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取。

- ② 细菌/细胞样本：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，在 4℃ 或冰浴进行匀浆(或使用各类常见电动匀浆器)。4℃ 约 12,000rpm 离心 10min，取上清待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10^4)：提取液(mL)为 500~1000：1 的比例进行提取。

- ③ 液体样本：直接测定。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

- ① 酶标仪预热 30 min，调节波长到 412 nm（若无此波长，可在 420nm 下检测）。
- ② 用排枪操作，以减小各孔间因加入试剂时间先后导致的误差。
- ③ 试剂一到五在 25℃水浴中预热 30min，在 EP 管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
试剂一	80	80
样本	80	
蒸馏水		80
试剂二	40	40
25℃条件下反应 5min(严格控制时间)		

试剂三	800	800
若有沉淀, 需 12000rpm 室温离心 10min, 上清液待测。		


④显色反应: 在 96 孔板中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管	空白管
上述步骤的上清液	80	80
试剂四	100	100
试剂五	20	20
反应 2min 后, 于 412nm 波长读取吸光值 A, $\Delta A = A_{\text{空白管}} - A_{\text{测定管}}$ 。		

【注】: 1. 最后一步的显色反应, 务必在 5min 之内读取吸光值。若 ΔA 在零附近, 可增大加样量 V_1 (如增至 160μL, 则试剂三相应减少, 总体积不变), 或增加第③步反应时间 T (如由 5min 增至 15min 或更长), 或增加样本质量 W 。则改变后的 V_1 和 T 和 W 需要代入公式重新计算。
2. 若 A 测定值小于 0.1 或 ΔA 大于 0.65, 可减少 V_1 (如减至 20μL, 则增加相应体积蒸馏水, 保持总体积不变) 或对样本用蒸馏水稀释后测定, 则改变后的 V_1 和稀释倍数 D 需代入公式重新计算。

五、结果计算:

1. 标准曲线: $y = 3.6568x - 0.0103$ 。x 是 GSH 摩尔浓度: μmol/mL, y 为吸光值 ΔA 。

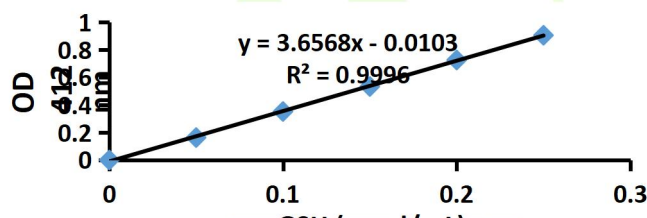

2. 按蛋白浓度计算:

酶活定义: 在 25°C 反应条件下, 每毫克蛋白每分钟氧化 1nmol GSH 为 1 个酶活单位。

$$\text{GPx 酶活 (nmol/min/mg prot)} = [(\Delta A + 0.0103) \div 3.6568 \times 10^3 \times V_2] \div (C_{\text{pr}} \times V_1) \div T \times D \\ = 683.7 \times (\Delta A + 0.0103) \div C_{\text{pr}} \times D$$

3. 按样本质量计算:

酶活定义: 在 25°C 反应条件下, 每克样本每分钟氧化 1nmol GSH 为 1 个酶活单位。

$$\text{GPx 酶活 (nmol/min/g 鲜重)} = [(\Delta A + 0.0103) \div 3.6568 \times 10^3 \times V_2] \div (W \times V_1 \div V) \div T \times D \\ = 683.7 \times (\Delta A + 0.0103) \div W \times D$$

4. 按细胞数量计算:

酶活定义: 在 25°C 反应条件下, 每 10^4 个细胞每分钟氧化 1nmol GSH 为 1 个酶活单位。

$$\text{GPx 酶活 (nmol/min/10}^4 \text{ cell)} = [(\Delta A + 0.0103) \div 3.6568 \times 10^3 \times V_2] \div (500 \times V_1 \div V) \div T \times D \\ = 683.7 \times (\Delta A + 0.0103) \div 500 \times D$$

5. 按液体体积计算:

活性单位定义: 在 25°C 反应条件下, 每毫升液体每分钟氧化 1nmol GSH 为 1 个酶活单位。

$$\text{GPx 酶活 (nmol/min/mL)} = [(\Delta A + 0.0103) \div 3.6568 \times 10^3 \times V_2] \div V_1 \div T \times D = 683.7 \times (\Delta A + 0.0103) \times D$$

V ---提取液体积, 1 mL; V_1 ---加入反应体系中上清液体积, 80μL=0.08 mL;

V_2 ---反应阶段的反应总体积, 1000μL=1mL; D ---稀释倍数, 未稀释即为 1;

W ---样本质量, g; GSH 分子量---307.3; T ---反应时间, 5min; 500---细菌/细胞数量, 万;

C_{pr} ---上清液蛋白浓度 (mg/mL); 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (2.5μmol/mL): 用前使粉体落入底部, 再加 1.6mL 蒸馏水溶解 (-20°C 保存两天)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度: 0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 μmol/mL。
- 3 显色反应阶段, 在 96 孔板中依次加入: 80μL 标准品+100μL 试剂四+20μL 试剂五, 反应 2min 后, 于 412nm 波长读取吸光值 A , 依据结果即可制作标准曲线。