

土壤硝酸还原酶（Solid-Nitrate Reductase, S-NR）试剂盒说明书

（货号：ADS-F-TR006 分光法 24 样）

一、产品简介：

土壤硝酸还原酶可以把土壤中的硝酸盐转变为亚硝酸盐，然后再通过亚硝酸还原酶的作用转变成氮循环的重要原料-铵，从而调节氮代谢，并影响到光合碳代谢，进而影响植物生长。

本试剂盒提供一种快速、精确的测定方法，土壤硝酸还原酶催化硝酸盐还原为亚硝酸盐；同时抑制亚硝酸还原酶对产生的亚硝酸盐的降解，亚硝酸盐与对应的显色剂反应生成（粉）红色偶氮化合物；该物质在 540nm 有最大吸收峰，进而得出土壤硝酸还原酶的活性。

二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	液体 15mL×1 瓶	4°C保存	
试剂二	液体 3mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 30mL×1 瓶	4°C保存	
试剂四	液体 14mL×1 瓶	4°C保存	
试剂五	A 液 12mL×1 瓶	4°C保存	临用前，可依据待检测样本数量，把 A 液和 B 液等比例混合成无色的反应 mix（注意观察，若变粉色，则不能使用）。两天之内用完。
	B 液 12mL×1 瓶		
标准品	粉体 1 支	4°C保存	若重新做标曲，则用到该试剂

三、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、水浴锅、台式离心机、可调式移液器。

四、土壤硝酸还原酶（S-NR）的测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

取新鲜土样风干或者 37 度烘箱风干，先粗研磨，过 40 目筛网，备用。

【注】：土壤风干，减少土壤中水分对于实验的干扰；土壤过筛，保证取样的均匀细腻；

2、测定步骤

① 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零。

② 在 1mLEP 管中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管	对照管
风干土样（g）	0.25	0.25
试剂一	200	200
试剂二	50	50
蒸馏水	250	250
	混匀，且务必用封口膜封口。25°C培养 24h	混匀，且务必用封口膜封口。-20°C培养 24h（可放在-20°C冰箱）
试剂三	500	500
混匀，12000rpm，4°C离心 10min，上清液待用		


③ 显色反应，在 EP 管中依次加入：

上清液	160	160
试剂四	240	240
反应 mix	400	400
混匀，25°C反应 5min（准确时间），全部液体转移至 1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）中，立即于 540nm 处读取 A 值， $\Delta A=A$ 测定-A 对照（每个样本做一个自身对照管）。		

【注】：若 ΔA 低于 0.01，可增加第③步中上清液体积 V2（如由 160 μ L 增至 300 μ L，则试剂四减至 100 μ L，保持总体积仍为 800 μ L），则改变后的 V2 带入公式重新计算。

五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 0.0407x - 0.0065$ ；x 为标准品摩尔质量（nmol），y 为吸光值 ΔA 。

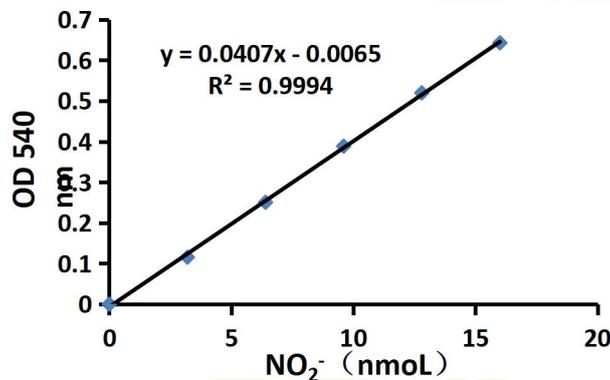

2、单位定义：每天每克土样中产生 1 μ mol 的 NO₂⁻ 的量为一个酶活力单位。

$$S-NR(\mu\text{mol/d/g 干土}) = [(\Delta A + 0.0065) \div 0.0407 \times 10^{-3} \div V2 \times V1] \div W \div T$$

$$= 0.153 \times (\Delta A + 0.0065) \div W$$

3、单位定义：每天每克土样中产生 1 μ g NO₂⁻ 的量为一个酶活力单位。

$$S-NR(\mu\text{g/d/g 干土}) = [(\Delta A + 0.0065) \div 0.0407 \times 10^{-3} \div V2 \times V1] \div W \div T \times 46$$

$$= 7.06 \times (\Delta A + 0.0065) \div W$$

V1----反应体系总体积，1mL；

V2---③步中上清液体积，160 μ L=0.16mL；

T----反应时间，24h=1d；

W----样本实际质量，g；

标准品的分子量---69；

NO₂⁻的分子量---46。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（100 μ mol/mL）：把标准品完全溶解于 1mL 蒸馏水中（母液需在两天内用且-20°C 保存）。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度标准品：0, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.2. μ mol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据显色反应阶段的测定管的加样顺序操作，根据结果即可制作标准曲线。